STRUTTURA
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grippante all'interno ed all'esterno per CVO-700 ECO
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompetta nella versione CVO-700P ECO

STRUTTURA STABILIZZATRICE
- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. regolabile mediante pin
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- regolazione dell'articolazione R.O.M. della dorso flessione da 0° a 45° e della planta flessione da 0° a 45°ogni 7.5 e possibilità di immobilizzazione a 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45°

CHIUSURA
- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa
S	36–39
M	40–42
L	43–45
XL	Oltre 45

Altezza
40 cm

Codici d'ordine:
CVO-700ECO (normale);
CVO-700P ECO (pneumatico)

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.
Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Tutore walker per tibio-tarsica regolabile R.O.M. Economy

CVO-700 ECO
CVO-700P ECO

Orthopedic & Rehabilitation Equipment

FGP

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRCVO700E
Rev. 16 - 01/24

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

Fabbricante
Dispositivo medico
Codice prodotto
Codice lotto
Conservare in ambiente secco
Consultare le istruzioni d'uso
Uso multiplo singolo paziente
Conservare lontano da fonti di calore

CVO-700P ECO

INDICAZIONI: tutore destinato al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione tibio-tarsica. Utile, ad esempio, nei casi di: distorsioni di caviglia I, II, III grado; esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso; trattamento della pseudoartrosi base V metatarso; esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale; post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

⚠ AVVERTENZE D'USO
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul MD in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

⚠ La prima regolazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Rimuovere l'ortesi dall'involucro di plastica, aprire tutti i nastri a strappo delle cinghie e staccare lo stivaletto dalla base.
2. Aprire la chiusura frontale dello stivaletto. Chiedere al paziente di inserire il piede e il polpaccio nello stivaletto (fig. 1).
3. Chiudere la chiusura frontale dello stivaletto (fig. 2).
4. Chiedere al paziente di posizionare il piede nella base del tutore tra le due stecche. Il piede va posizionato in modo tale che le due aste siano centrate sulla linea mediana della gamba.
5. In dotazione ci sono dei comodi cuscinetti in materiale espanso che possono essere spostati per aumentare il comfort oppure rimossi per aumentare l'ampiezza mediolaterale tra le aste.
6. Il nastro a strappo all'interno delle aste aderirà allo stivaletto.
7. Stringere le due cinghie dell'avampiede (fig. 3).
8. Stringere le tre cinghie che fissano il polpaccio tra i montanti, partendo dalla cinghia più vicina alla caviglia. Queste cinghie puntano in direzioni alternate per evitare rotazioni (fig. 4).
9. Chiedere al paziente di camminare con l'ortesi per accertarsi che essa sia stata applicata e funzioni correttamente.

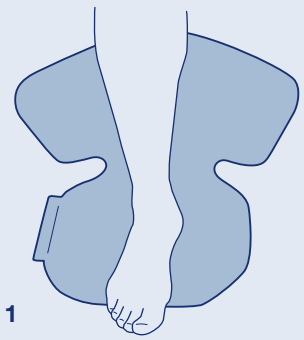
1

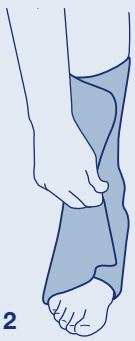
2

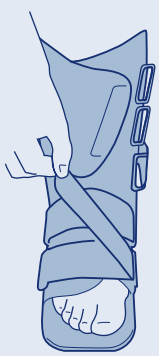
3

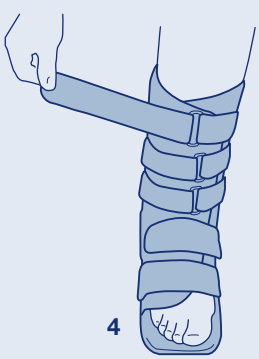
4

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE





1. Aprire il cappuccio in corrispondenza della vite di sicurezza.
2. Rimuovere temporaneamente la vite di sicurezza tramite la brugola in dotazione.
3. Portare l'apertura del cappuccio in corrispondenza del pin di flessione o di estensione.
4. Estrarre il pin e riposizionarlo in corrispondenza dell'angolo richiesto, spostando opportunamente le aste.
5. Riposizionare l'apertura sulla sede della vite e reinserirla avendo cura di avvitarla completamente.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

⚠ Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se l'ortesi viene rimossa durante una visita medica, è possibile togliere l'ortesi semplicemente aprendo le cinghie e la chiusura frontale dello stivaletto. In tal modo, il paziente potrà riapplicare lo stivaletto e l'ortesi con l'adeguato allineamento della gamba.

PER VERSIONE PNEUMATICA



A. Gonfiare l'imbottitura con la pompetta presente nell'apposita tasca (fig. A).

B. Gonfiare con l'estremità trasparente della pompetta e sgonfiare con l'estremità nera.